

# 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更日 令和2年4月6日（月）受付分より

■変更項目

アルブミン【A I b】	(項目コード: 1002)	} ※検査案内 p35
アルブミン・グロブリン比【A/G】	(項目コード: 1071)	
カルシウム【Ca】	(項目コード: 1035<血清>, 1405<蓄尿>, 1425<尿>)	

※検査案内 p46

## 1. アルブミン、アルブミン・グロブリン比

アルブミンの測定法であるBCG法を特異性の向上したBCP改良法へ変更させていただきます。これに伴い、基準範囲も変更させていただきます。

検査項目	変更箇所	新	旧
1002 アルブミン【A I b】	測定方法	BCP改良法	BCG法
	基準範囲	3.8~5.2g/dL	3.7~5.2g/dL
1071 アルブミン・グロブリン比【A/G】	測定方法	BCP改良法によるアルブミンを用いた計算法	BCG法によるアルブミンを用いた計算法

<参考>

BCG法とBCP改良法による測定値の差につきましては、日本臨床検査医学会では、BCP改良法の測定値が3.5g/dL以下の場合、測定値に0.3g/dLを加えた値をBCG法での推測値と近似するのが妥当であると提言しています。




## 2. カルシウム

カルシウムにつきましては、現行試薬に比べ保存安定性に優れたアルセナゾⅢ法試薬へ変更させていただきます。これに伴い、報告下限値を変更させていただきます。

検査項目	変更箇所	新	旧
1035<血清> カルシウム【Ca】	測定方法	アルセナゾⅢ法	MXB法
	報告下限値	血清 0.1未満 mg/dL 尿 0.1未満 mg/dL	血清 0.2 mg/dL 尿 0.1 mg/dL

(裏面へ続く)

## ■相 関

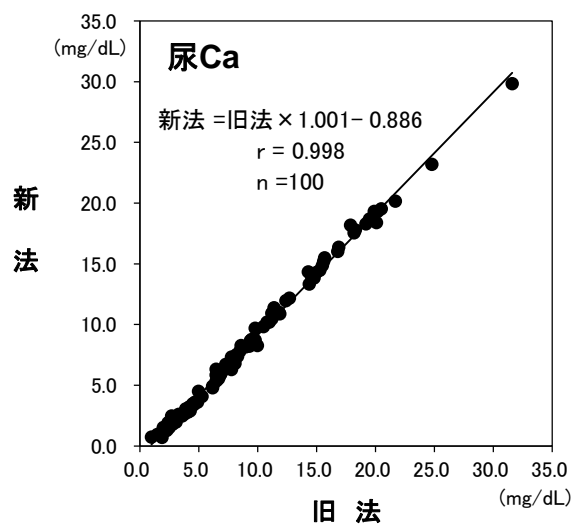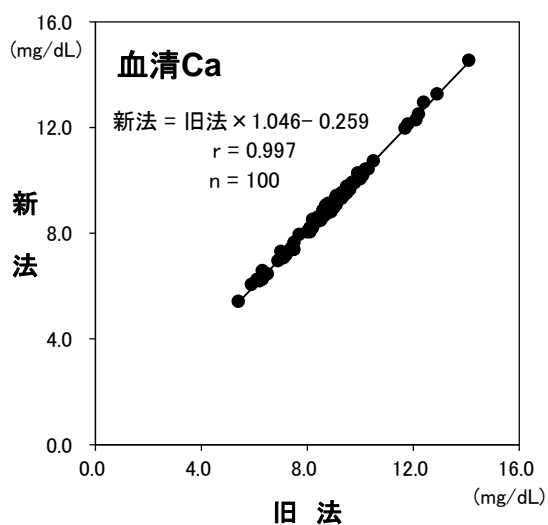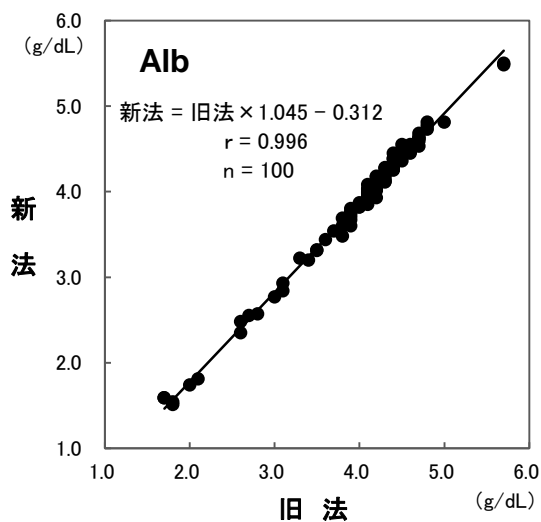

## ■依頼方法

アルブミン（BCP改良法）、アルブミン・グロブリン比（BCP改良法）、カルシウム（アルセナゾⅢ法）のご依頼は、従来のまま（A）検査依頼書の現マークポジションをご使用下さい。

以上

\*お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション

2020-A-002